CHEUN

Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

HYALURONIC ACID FILLER + LIDOCAINE

为您的美丽，量身塑形

交联透明质酸 20 mg/mL · 利多卡因 0.3% · 1.1 mL

48° **大分子** 鼻 · 下巴

32° **中分子** 面颊 · 深层

16° **小分子** 唇 · 泪沟 · 细纹

CHEUN BIOTECH



CHEUN

Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

ABOUT CHEUN

CHEUN 玻尿酸 · 汇聚专注与专业的创新产品

先进 HA 制造技术

精选安全、高品质成分，进一步强化安全性与品质

双相 + 单相优势结合

兼具柔和与支撑力，塑形自然、效果持久

严格品质管理

采云生物科技在洁净生产设施中，依严格品质标准制造

持续临床验证

正在进行欧盟 CE 认证相关临床，持续验证效果与安全性



CHEUN BIOTECH

CHEUN
Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

02

KEY SPECIFICATIONS

核心规格

20 mg/mL
交联透明质酸浓度

0.3 %
利多卡因 · 减轻注射不适

1.1 mL
预灌封注射器 / 支

未检出
BDDE 残留（≤ 2 ppm 标准）

成分	交联透明质酸钠 20 mg/mL + 盐酸利多卡因 0.3%
规格	1.1 mL / 1 支预灌封注射器
型号	CHEUN 48° · 32° · 16°（按颗粒 / 分子大小区分）
性状	无色透明凝胶
制造商	韩国 采云生物科技（CHEUN BIOTECH）



CHEUN
Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

03

LINE-UP

三种型号 · 按部位精准选择



CHEUN 48°

大分子

Large

适用部位	鼻、下巴
注射层次	骨膜上 / 皮下深层
维持时间	12–18 个月



CHEUN 32°

中分子

Medium

适用部位	面颊、法令纹、深层组织
注射层次	真皮深层 – 皮下 / 骨膜上
维持时间	12–18 个月



CHEUN 16°

小分子

Small

适用部位	泪沟、唇部、细纹
注射层次	真皮中层 – 真皮深层
维持时间	6–12 个月

PRODUCT DETAIL

CHEUN 48°



大分子 · 结构支撑

颗粒最大、支撑力最强，适合需要立体支撑与塑形的部位。

规格	1.1 mL / 支
适用部位	鼻梁、鼻尖、下巴
注射层次	骨膜上 / 皮下深层
推荐针头	25G 钝针 或 27G 锐针
维持时间	12–18 个月

PRODUCT DETAIL

CHEUN 32°



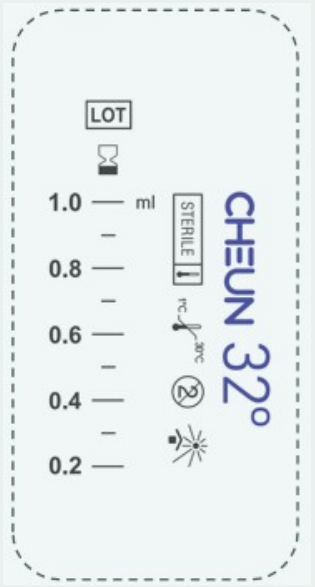

中分子 · 容量填充

支撑与柔和兼具，适合面中部容量恢复与深层皱纹。

规格	1.1 mL / 支
适用部位	面颊、苹果肌、法令纹、深层组织
注射层次	真皮深层 – 皮下 / 骨膜上
推荐针头	25–27G 钝针 或 27G 锐针
维持时间	12–18 个月

PRODUCT DETAIL

CHEUN 16°



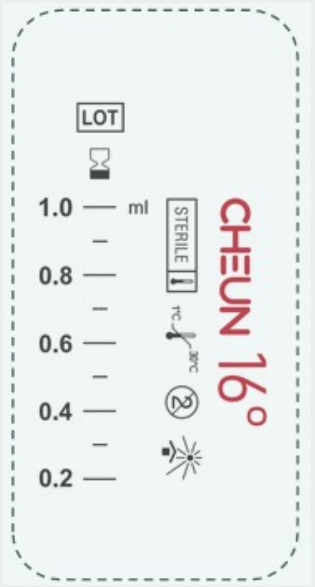

小分子 · 精细塑形

质地柔软细腻，适合精细部位与细纹。

规格	1.1 mL / 支
适用部位	泪沟、唇部、细纹
注射层次	真皮中层 – 真皮深层（泪沟：钝针骨膜上 / 皮下）
推荐针头	27–30G 锐针 或 27G 钝针
维持时间	6–12 个月

CHEUN
Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

INJECTION PLANES

注射层次与型号选择

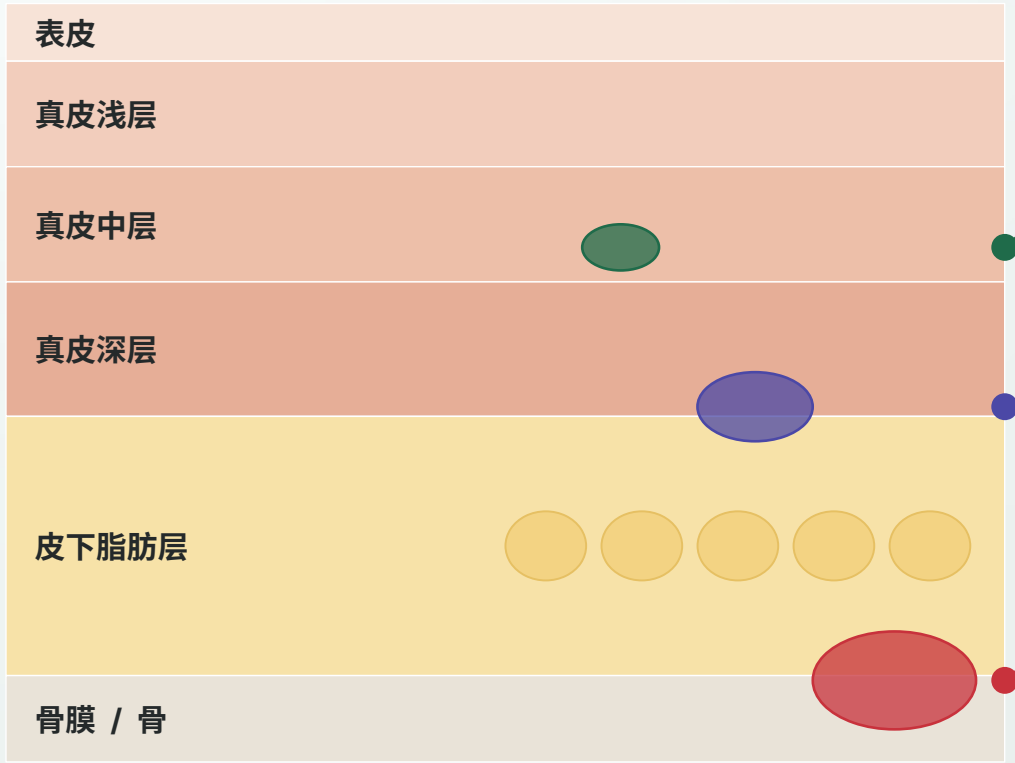

CHEUN 16° 真皮中层 – 深层：唇部、细纹

CHEUN 32° 真皮深层 – 皮下：法令纹、面颊容量

CHEUN 48° 骨膜上 / 皮下深层：鼻、下巴支撑

避免 真皮浅层注射（易出现凸起、丁达尔现象）；血管内注射

INDICATIONS & DOSAGE

部位与参考用量

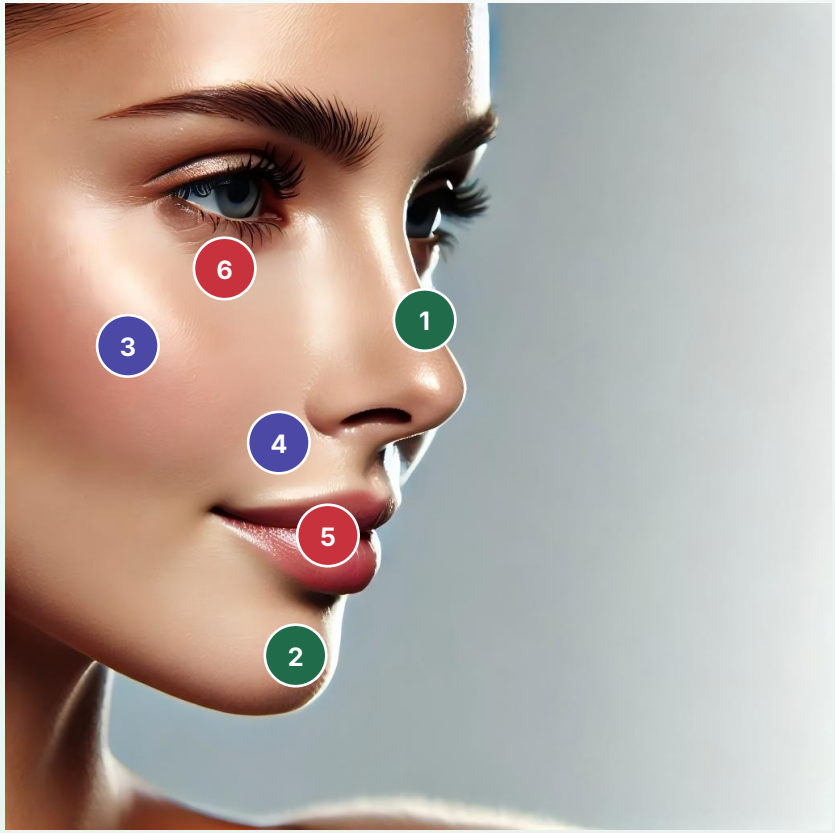

部位	型号	层次	工具 / 手法	参考用量
① 鼻梁 · 鼻尖	48°	骨膜上 / 皮下深层	25G 钝针 · 线性退针	0.5–1.0 mL
② 下巴	48°	骨膜上	27G 锐针 · 团注 / 钝针	1.0–2.0 mL
③ 面颊 · 苹果肌	32°	骨膜上 / 皮下	25G 钝针 · 扇形	1.0–2.0 mL / 侧
④ 法令纹	32°	真皮深层 – 皮下	27G 锐针 / 钝针 · 线性	0.5–1.0 mL / 侧
⑤ 唇部	16°	唇红黏膜下	30G 锐针 · 线性 / 点注	0.5–1.0 mL
⑥ 泪沟	16°	骨膜上 / 皮下深层	27G 钝针 · 少量线性	0.3–0.5 mL / 侧

* 参考用量请由医生根据个体情况调整；注射前回抽，少量缓慢推注，避免过度矫正。

QUALITY CONTROL

品质检测结果

CHEUN 在先进的生产设施中，依严格品质标准制造，每批产品均经过以下检测。

BDDE 未检出

残留交联剂

12.0 N

推注顺畅（标准 ≤ 40 N）

< 0.5 EU/mL

内毒素远低于标准

检测项目	标准	结果
外观	无色透明凝胶	符合
pH	5.5 – 8.5	7.0
鉴别（FT-IR）	与对照图谱一致	符合
复数黏度	1,000,000 – 2,200,000 cP	1,436,410 cP
BDDE 残留	≤ 2 ppm	未检出
HA 含量	18.0 – 22.0 mg/mL	20.2 mg/mL
利多卡因	0.27 – 0.33%	0.30%
细菌内毒素	≤ 5.0 EU/mL	< 0.5 EU/mL
无菌	无菌	符合
推注力	≤ 40 N	12.0 N
重金属	不深于对照液	符合
渗透压	330 ± 50 mOsm/kg	326 mOsm/kg

结论：随机抽样检测结果均符合规定标准。

AFTERCARE

术后护理与注意事项

术后注意

- 注射后轻柔按压塑形，避免用力揉搓
- 24 小时内避免化妆，保持注射部位清洁
- 1–2 周内避免桑拿、高温、剧烈运动及饮酒
- 2 周内避免对注射部位施压（如趴睡、按摩）
- 轻微红肿、淤青通常数日内消退

禁忌与慎用

- 对透明质酸或利多卡因过敏者
- 注射部位感染、炎症或皮肤病
- 孕期及哺乳期
- 凝血功能障碍或服用抗凝药物者慎用
- 瘢痕体质、自身免疫性疾病者慎用



CHEUN

Hyaluronic Acid Filler + Lidocaine

持续创新，打造更安全、更优质的 CHEUN 玻尿酸

感谢您一直以来的支持

CHEUN BIOTECH

www.cheunbiotech.com

韩国 采云 生物科技 株式会社

